

ANALYSES DANS LES MATERIAUX

AMIANTE, PCB, HAP, HBCD

ENVOIS, CRITÈRES D'ÉCHANTILLONNAGE ET PRIX

1. Critères d'échantillonnage

- ▶ Les échantillons transmis doivent respecter les critères d'échantillonnage « Annexe : description des critères d'échantillonnages ».

2. Envoi des échantillons

- ▶ Les échantillons d'un même dossier doivent être rassemblés dans un sachet étanche et propre, avec la référence unique de celui-ci.
- ▶ Les échantillons peuvent être transmis par DHL (inclus dans le prix d'analyse). Un compte peut être créé sur demande. Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire de Gland (VD).
- ▶ La liste des échantillons (format Excel ou PDF) doit être envoyée par email à labo.vd@hseconseils.ch avec le type d'analyse souhaité (polluants et délai).

3. Prix

	Analyse Standard		Analyse Urgente		Kit de prélèvement
Amiante	3 – 5 jours	CHF 30.- CHF 25.- dès 50 éch./mois	2h	CHF 65.-	CHF 2.- ▶ 1 couronne Ø20mm ▶ 1 mousse ▶ 1 bouchon Ø20mm (noir ou blanc)
PCB / HAP / HBCD	3 – 5 jours	CHF 100.-	36h	CHF 180.-	

- ▶ Délai standard : résultats sous 3-5 jours dès réception des échantillons (le jour d'arrivée des échantillons au laboratoire étant J-0). Inclus la fourniture d'un tube pour les prélèvements amiante.
- ▶ Délai urgent :
 - Amiante : résultats sous 2h dès réception des échantillons, pour un maximum de 15 échantillons. Au-delà, contacter le laboratoire pour connaître le délai. Inclus la fourniture d'un tube.
 - PCB/HAP/HBCD : résultat sous 36h dès réception des échantillons, pour un maximum de 5 échantillons. Au-delà, contacter le laboratoire pour connaître le délai.


Annexe : Description des critères d'échantillonnages


1. Amiante

- ▶ L'échantillon doit être transmis dans un tube à centrifuger à fond conique avec jupe, gradué ou non, en polypropylène, 50 ml, non stérile. Le bouchon doit être correctement fermé (jusqu'au bout de la vis).
- ▶ Le sachet (ou autre conditionnement) contenant les tubes doit être étanche et propre. L'extérieur des tubes eux-même doivent être propres, sans poussières.





- ▶ L'échantillon doit se trouver dans la zone conique du fond du tube, idéalement ni plus ni moins. Seule la matière à analyser doit être présente dans le tube.
- ▶ Exception : les carottes de diamètre 20mm maximum sont acceptées même si elles sont plus grande que la partie conique, pour autant qu'elles soient composées uniquement du carreau + colle

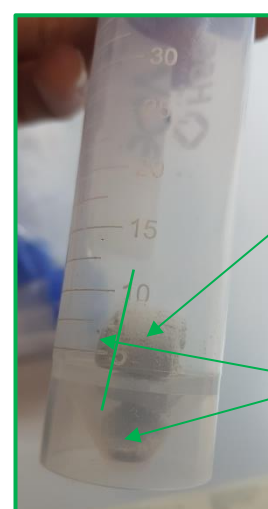

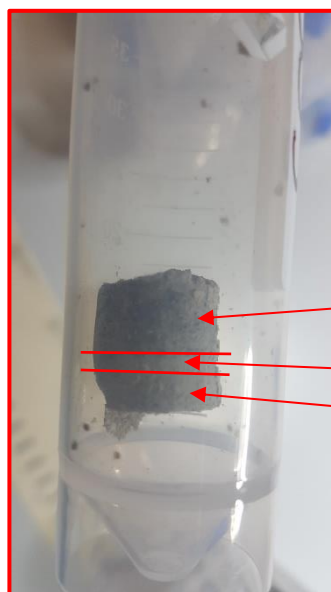

- L'échantillon peut dépasser de la zone « conique », mais doit toucher le fond du tube

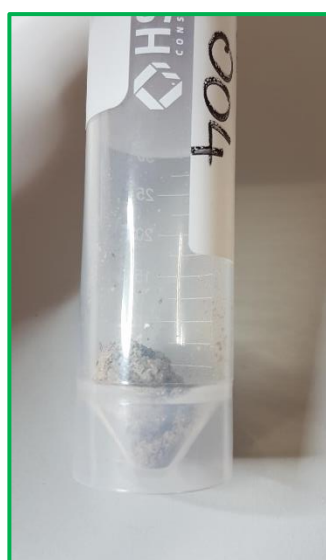

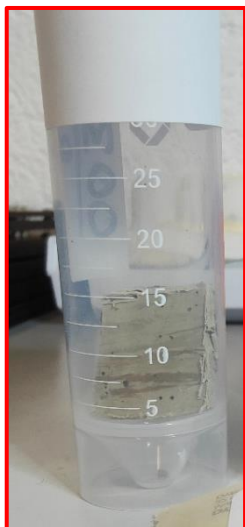



- La matière à analyser ne doit pas être prise entre 2 couches. Elle doit être en contact avec les solutions qui vont être utilisées pour la préparation



2. PCB

Les échantillons doivent être :


- ▶ Conditionnés dans du papier aluminium facilement réouvrable, lui-même ensaché
- ▶ Secs ou prélevés avec de l'acétone ou un décapant de peinture
- ▶ Quantité entre 1 et 3 g. Exemples :

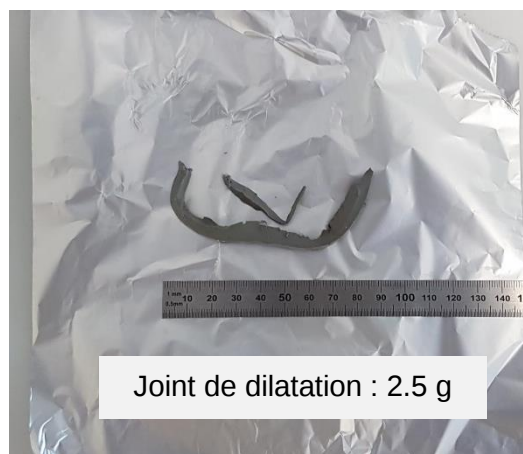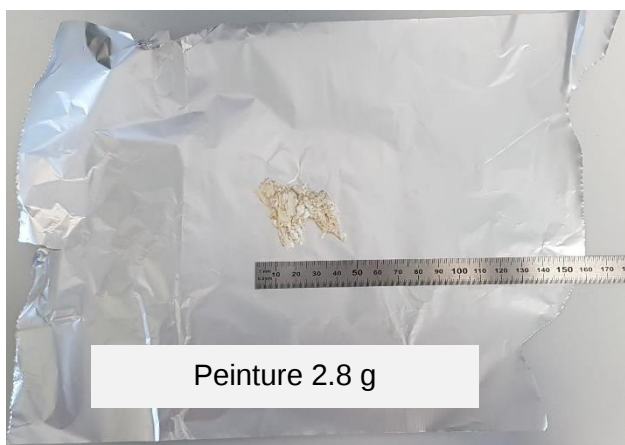

3. HAP

Les échantillons doivent être :

- ▶ Doublement emballés
- ▶ Secs
- ▶ Quantité entre 1 et 3 g. Exemples :

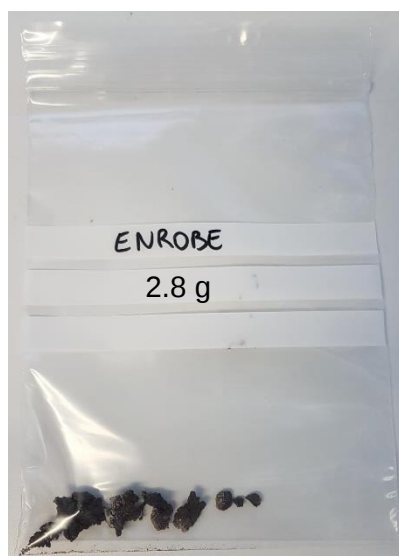

4. HBCD

Les échantillons doivent être :

- ▶ Conditionnés dans du papier aluminium, lui-même ensaché
- ▶ Quantité entre 1 et 3 g. Exemple :

